

ZHONGNAN PHARMACEUTICAL MACHINERY FACTORY



中南制药机械厂

ZhongNan Pharmaceutical Machinery Factory



中南药机 售后服务

目 录

CONTENTS

①

公司简介

Company Introduction

②

安瓿生产线介绍

Production Line

③

产品介绍

Products

④

合作单位展示

Clients

公司简介

Company Introduction




中南制药机械厂，是我国制药机械行业知名企业之一，是国内制药企业和医药设计院首选推荐的设备制造商。据不完全统计，50余年来，我国有三分之二以上的制药厂使用了中南制药机械。部分医院、化工厂、生物制品厂、粮油食品厂、兽药厂、农药厂同时使用了中南制药机械。

本厂总部座落在长沙市国家高新技术产业区，是获得国家创新基金支持的优质企业，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证。主要产品有：压片机系列、粉碎机系列、胶囊充填机系列、包装机系列、液体灌装系列等60余种。目前全球有美国、加拿大、日本、俄罗斯、韩国、埃及、马来西亚、法国、德国、朝鲜、越南、香港等19个国家和地区使用了本厂产品。

本厂根据市场发展情况，研发生产出成套的制药教学设备，专供高中等院校实验室教学及模拟生产使用，其中有：片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、口服液、水针及小型软膏生产线；并且研发了仿真教学软件，具有独立知识产权，已申报省、市科技计划项目。

安瓿生产线介绍

Production Line

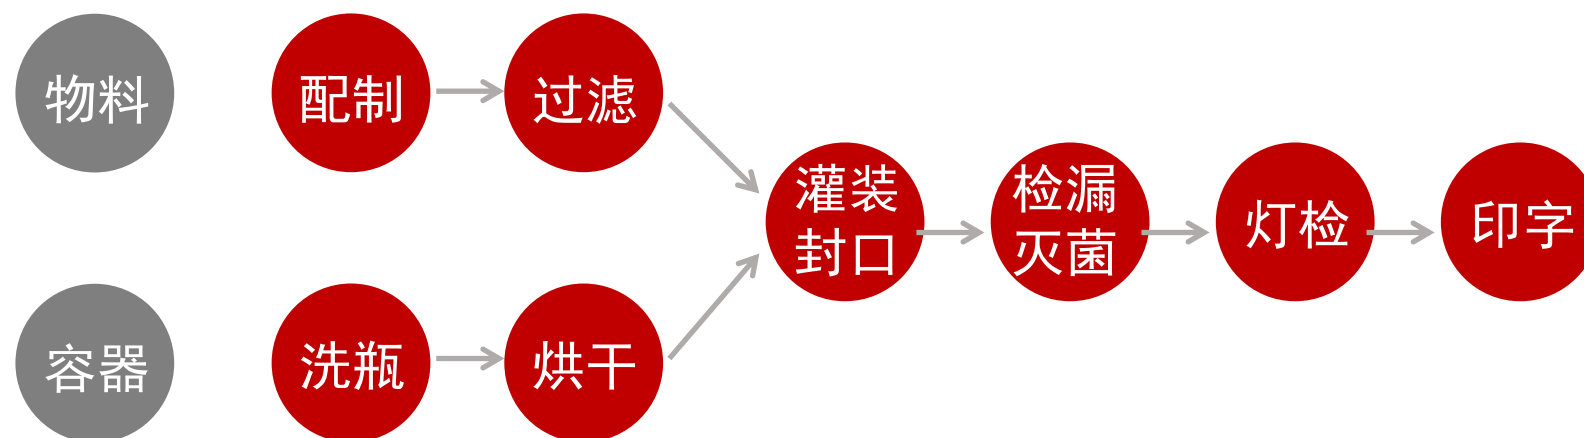

设备价格

序号	设备型号名称	市场价格 (元)	备注要求	序号	设备型号名称	市场价格 (元)	备注要求
1	RF-1型一体式安瓿熔封机			11			
2	ALG2/1-2安瓿拉丝灌封机			12			
3	ADJ安瓿灯检机			13			
4	YZ安瓿印字机			14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

产品介绍

Products



RF-1型一体式安瓿熔封机

传统的安瓿熔封机，由控制箱和熔封台两部分组成，在长期使用中发现有如下缺点：准备时需要临时接插助燃气管；控制箱和熔封台摆放调节不方便；使用完毕须拔去气管，再分两部分提拿、搬动、收存。重复使用时，容易出现：控制台和熔封台配套混乱，接插不顺，火焰调整不稳，丢失零配件情况。为此，我们将两体机改进为一体机，助然气泵管已事先接插好，使用时，只需接通煤气或石油液化气，调整煤气和助燃气开关，即可得到均匀集中的火焰。加热安瓿时，可缓慢旋转圆形安瓿摆放平台，使瓶颈加热均匀，待软化时，用镊子将安瓿瓶颈上端往上拉断，安瓿瓶颈下方即可光滑熔封。本机工作时无噪声，熔封速度快，准备、收存方便，整机简洁，是医院、制剂室、学校、科研单位、小药厂、生物制剂厂熔封安瓿的理想设备。

本机是我厂专利产品。

主要技术参数：


- 1、型 号：RF-1
- 2、适用规格：1-20ml
- 3、产 量：600-800支/时
- 4、电 压：220 V
- 5、功 率：7 W
- 6、助燃气压力： ≥ 0.04 KPa
- 7、燃 气 压 力： ≥ 0.4 KPa
- 8、净 重：3.2 kg
- 9、装 箱 体 积：300X180X350 mm



ZHONGNAN PHARMACEUTICAL
MACHINERY FACTORY

产品介绍

Products

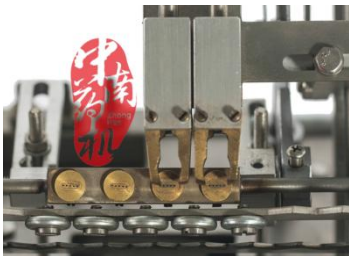


ALG系列安瓿拉丝灌封机

本机是一种稳定可靠的产品，适用于标准安瓿及异形安瓿的灌装封口，可单机使用或连接生产线。近年来，我厂又进行了一系列技术、材料选择改进，使其更为完善。、主要改进处如下：1、间隙移动送瓶部分采用不锈钢直线杆及德国易格斯直线滑套。2、输瓶轮部分采用轴承。3、连续进瓶段加长消除进瓶处卡瓶及碎瓶现象。4、本系列有七款机型，用户可根据安瓿生产量不同及规格不同选择机型。



型号	ALG双针/1-2	ALG单针/5-10	ALG双针/5-10	ALG四针/1-2	ALG四针/5-10	ALG六针/1-2	ALG六针/5-10
规格ml	1-2	5-10	5-10	1-2	5-10	1-2	5-10
产量支/时	4900	1800-2000	3200-4200	6000-7000	5000-6000	10000-11000	6000-7000
功率kw	0.37		0.55				
燃料	石油液化气（配置氧气助燃）						
电压v	380v或220v（用户自选）						
外型尺寸mm	1000X700X1000	1000X700X1000	1200X750X1000	1500X930X1300	1500X980X1300	1600X930X1300	1850X980X1300
重量kg	75	78	120	180	250	280	280

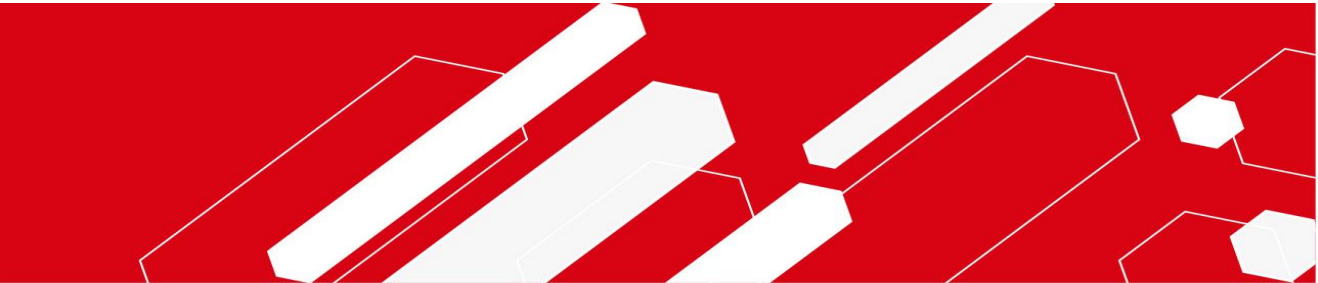

产品介绍

Products

ADJ安瓿灯检机

本机适用于对安瓿封口状况、药剂装量及其是否含有杂质等项目的检测。透明瓶及药液经白色光源透照，放大镜适度放大，各项待检项目清晰可辨。

主要技术参数：


- 1、适用瓶型： 1-30ml 安瓿（非标瓶可定制）

2、灯检速率： 70-80 瓶/分钟

3、检测方式： 白色灯透照目测，放大2倍

4、设备功 率： 300w 220v

5、外型尺寸：1300X580X1250 mm³

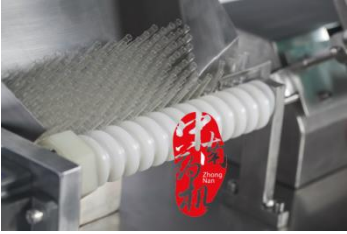

YZ安瓿印字机

简介与特点：

具有如下几个显著优点：安瓿无论大小，均可印制4行文字或符号，内容包括：品名、剂量、规格含量、生产日期、生产批号、有效期等。如须加印商标或图案，我厂也可定制。

字迹清晰。主要是在油墨辊轮上作了改进，使油墨保持均匀。在与安瓿直接接触的印字辊轮上，装有精微调节部件，可精确调整安瓿与辊轮接触位置，并稍具弹性，这样可使个别不规则安瓿或当安瓿快速下落产生偏差时，能起到“自适应”调整作用，确保安瓿与辊轮接触均匀，无滑动，因而印出的字迹清晰。

因为印字速度太快，有的厂家不需要太快速度，同时为缓解操作人员紧张情绪，本机特别备有调速机构，用户可自行调节印字快慢。

本机在机器前端即可放入打开盒盖的纸盒。为使运行平稳，本机特意安装了一根长钢丝，目的是使打开的纸盒盖能搭放在钢丝上，这样确保纸盒底部平坦，因而印好字的安瓿能顺利、准确掉落入盒中并排列好。同时本机装盒轨道长达2600mm，操作人员完全能从容检查和调整印字及装盒质量。

主要技术参数：

- 1、主要型号：YZ1/20型

YZ5/10型

2、适用范围：1或20毫升安瓿水粉针

5或10毫升安瓿水粉针

3、理论产量：20000—25000 支/h


9000—138000 支/h

4、操作人员：连人工开盒关盒：5—6人

5、耗用功率：370w 电动机一台 60w 电动机一台

6、净 重：280 kg

7、外型尺寸：2800X600X1600 mm³

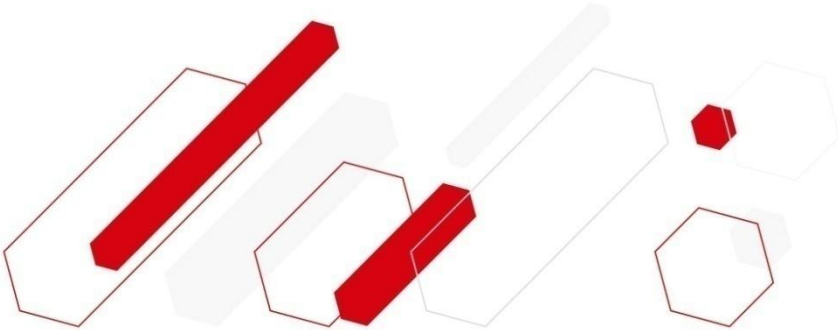

合作单位展示 （排名不分先后）

Clients

湖南省

- 中南大学
- 湖南大学
- 湖南农业大学
- 湖南省中医药大学
- 湘雅医学院
- 湖南国防科技大学
- 湖南省医药学校
- 湖南工程学院
- 湖南科技大学
- 湖南化工职业技术学院
- 湖南中医药高等专科学校
- 湖南食品药品职业学院

- 湖南交通工程学院
- 湖南护理学校
- 长沙理工大学
- 长沙学院
- 长沙医学院
- 长沙卫生职业学校
- 邵阳学院
- 永州市职业技术学院
- 怀化学院
- 核工业卫生学校

湖北省

- 武汉大学
- 华中科技大学
- 中南民族大学

- 湖北中医学院药学院
- 湖北生物科技职业学院
- 武汉市同济医学院药学院
- 武汉职业技术学院
- 咸宁学院
- 潜江卫校

广东 广西 香港

- 南方医科大学
- 广州中医药大学
- 广州大学
- 广东省惠州卫生学校
- 广州岭南职业技术学院药学院
- 广东食品药品职业学院
- 华南农业大学

- 广东省江门中医学校
- 广东省粤东高级技工学校
- 中山大学
- 河源卫校
- 华南理工大学环境科学研究所
- 华南理工大学食品学院
- 肇庆医学高等专科学校
- 陈田外语学院
- 深圳大学
- 清华大学深圳研究生院
- 广西医科大学药学院
- 广西工学院
- 广西梧州学院
- 广西梧州市卫生学校



合作单位展示

(排名不分先后)

Clients

- 广西中医药大学
- 广西卫生职业技术学院
- 广西农业职业技术学院
- 北海卫校
- 钦州卫校
- 贺州职业学院
- 玉林师范大学
- 香港浸会大学
- 香港理工大学

江苏浙江上海

- 南京农业大学
- 南京工业大学

- 南京中医药大学
- 南京师范大学
- 南京市医药中等专业学校
- 江苏省师范大学
- 江苏食品药品职业学院
- 江苏省常州医药技工学校
- 扬州大学
- 苏州大学医学部
- 苏州卫生职业技术学院
- 泰州职业技术学院
- 盐城卫生职业技术学院
- 浙江大学
- 湖州师范学院
- 浙江师范大学

- 浙江省皮肤病预防研究所
- 温州医科大学
- 台州科技职业学院
- 嘉兴学院
- 绍兴文理元培学院
- 衢州职业技术学院
- 宁波大学
- 杭普医学院
- 上海交通大学
- 上海理工大学
- 上海中医院大学
- 上海海洋大学食品学院

云贵川 重庆

- 华西医科大学
- 四川农业大学
- 四川大学
- 四川理工学院
- 四川省中医药科学院中医研究所
- 四川省绵阳市师范学院
- 四川西昌学院
- 成都信息工程学院
- 成都大学
- 西华大学
- 重庆工商大学
- 重庆化工职院
- 重庆市医药卫生学校

合作单位展示

(排名不分先后)

Clients

- 西南大学
- 云南中医学院
- 云南技师学院
- 昆明医科大学
- 昆明学院
- 昆明冶金高等专科学校
- 楚雄农业学校
- 德宏职业学院
- 红河卫生职业学院
- 西南民族大学
- 西南师范大学
- 贵阳中医学院
- 贵州大学
- 贵阳医学院

- 贵阳护理职业学院
- 贵阳卫校
- 黔西南民族职业技术学院
- 铜仁职业学院
- 毕节卫校
- 毕节职业技术学院

北京 河北 河南

- 北京大学
- 清华大学
- 北京中医药大学
- 中国医学科学院
- 中国科学院半导体研究所
- 北京农学院
- 北京市农林科学院
- 北京医药器械学校

- 天津大学
- 天津农学院
- 天津渤海职业技术学院
- 南开大学
- 河北科技大学
- 河北北方学院
- 河北省廊坊市工程学校
- 河北医科大学科技总公司
- 河北工业职业技术学院
- 华北工程技术学校
- 张家口学院
- 沧州医学高等专科学校
- 河南省信阳职业技术学院药检系
- 河南省医学科学研究所
- 河南焦作中医药学校

- 三门峡职业技术学院
- 东北大学秦皇岛分校
- 宣武第三职业学校

东北三省

- 长春中医药大学
- 长春医学高等专科学校
- 吉林市北华大学
- 吉林省中医药科学院
- 吉林医药学院
- 吉林化工学院(药化系)
- 吉林省农业大学生命科技学院
- 吉林农业科技学院
- 黑龙江生物科技职业学院实验中心
- 黑龙江农垦科技职业学院
- 牡丹江医学院

合作单位展示

(排名不分先后)

Clients

- 大连化学物理研究所
- 延边大学农学院动物医学系
- 辽宁农业职业技术学院
- 大连化学物理研究所
- 东北林业大学
- 沈阳药科大学
- 东北师范大学
- 锦州医科大学

福建省

- 福州大学
- 福建农林大学
- 厦门大学医学院
- 厦门华侨大学

- 厦门集美大学
- 厦门大学化学工程与生物工程系
- 福建生物工程制药职业技术学院
- 闽南师范大学
- 宁德师范学院

其他地区

- 山东大学
- 山东中医药大学院
- 山东省荣成海洋职业学院
- 山东威海海洋技术职业学院
- 山东医学高等专科学校
- 泰山护理职业学院
- 兰州大学
- 江西农业大学
- 赣州卫校

- 萍乡卫校
- 江西南昌大学医学院药学系
- 安徽滁州学院
- 六安卫校
- 平凉市医学高等专科学校
- 赣南医学院
- 海南医学院
- 海南省农业学校
- 海南华南高级职业技术学校
- 海南药业技术工程学校
- 海南第三卫生学校
- 陕西中医学院
- 陕西宝鸡职业技术学院
- 枣庄科技职业学院医学系
- 巢湖职业技术学院卫校区

- 宁夏医科大学
- 宁夏职业技术学院
- 大同市卫生学校
- 甘肃中医学校
- 青海大学
- 青海师范大学
- 山西医科大学
- 北方民族大学





THANK YOU

感谢聆听，敬请指正。